



預期用途

使用說明
Mallya®魔力芽™裝置適用於相容的諾和諾德諾特筆®中記錄和無線傳輸劑量資訊。

- 裝置特點**
可用於：
- 記錄諾和諾德諾特筆®的注射增加劑量。
 - 記錄每次注射的日期和時間。
 - 當裝置與智慧型手機連接時，利用藍牙技術將每次注射的劑量、時間和日期等相關資訊傳輸到智慧型手機上的app。

臨床環境
Mallya®魔力芽™裝置供患者在其相容的注射筆及相同使用情境。Mallya®魔力芽™無已知的禁忌症。

包裝內容物



PN : 0274251



PN : 0373707




使用者手冊 x1




5V
≥ 500mA

注意：USB充電器不包含在內。請使用輸出5V和至少500mA的二級USB壁式充電器。

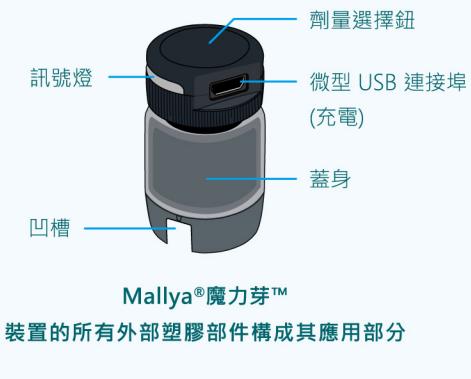

Mallya®魔力芽™
裝置的所有外部塑膠部件構成其應用部分



諾和諾德諾特筆®

瞭解 Mallya®魔力芽™和注射筆



諾特筆® (FlexTouch®)
專屬使用手冊
Connected diabetes*

開始使用 Mallya®魔力芽™

1 喚醒並給Mallya®魔力芽™充電

Mallya®魔力芽™在運送時被關閉。在使用之前，您需要喚醒它並確保電量充足。

1.1 將Mallya®魔力芽™連接到包裝內附的USB充電線。



1.2 將充電線插上電源插座。



10 min

1.3 在使用之前，讓裝置至少充電 10 分鐘。

10 min


1.4 拔下USB充電線和Mallya®魔力芽™，然後拔下充電器。




藍色訊號燈表示裝置尚未配對。

2 將Mallya®魔力芽™組裝到注射筆上

2.1 用一隻手握住注射筆，用另一隻手握住Mallya®魔力芽™蓋身，不要按下劑量選擇鈕。

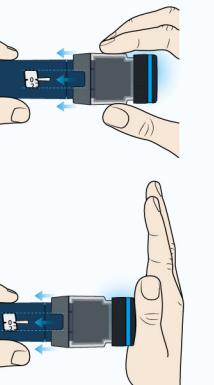

2.2 將Mallya®魔力芽™安裝到筆上的劑量按鈕，並將Mallya®魔力芽™的凹槽對準注射筆上的劑量視窗。

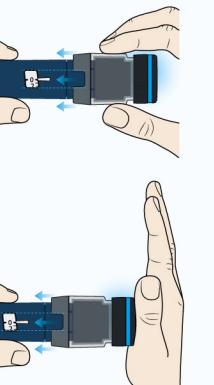

2.3 用手掌按壓按鈕，將Mallya®魔力芽™完全貼合注射筆。必須將其完全貼合在劑量設定鈕上。



2.4 確保Mallya®魔力芽™如圖所示正確安裝在注射筆上。

3 下載app並將Mallya®魔力芽™與之配對

在您使用Mallya®魔力芽™之前，您需要將其與您的智慧型手機上的app配對。



3.1 請參閱Mallya®魔力芽™網站
<https://my-mallya.com>
或掃描此QR code。


3.2 在 Google Play™ (Android) 或 App Store® (Apple) 上下載app。



3.3 請在您的智慧型手機上啟用藍牙。



3.4 將Mallya®魔力芽™與您的智慧型手機保持在 10 公分以內的距離。




3.5 打開app並按照說明配對Mallya®魔力芽™。一旦配對成功，Mallya®魔力芽™的訊號燈會變成綠色，然後熄滅。

3.6 裝置配對成功後，請按照連接的app說明進行操作。

4 啟用Mallya®魔力芽™

4.1 長按Mallya®魔力芽™按鈕 5 秒鐘，直至其訊號燈變為紫色。

4.2 鬆開手指，Mallya®魔力芽™的訊號燈變成綠色，表示Mallya®魔力芽™已經準備好可以使用。

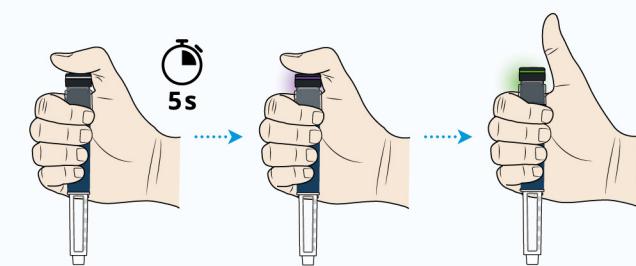

注意：如果Mallya®魔力芽™訊號燈未變成綠色，請確保Mallya®魔力芽™已充分安裝至您的筆上。重複步驟2.3，將Mallya®魔力芽™成功安裝至注射筆上以完全貼合。然後按照步驟4.1中的說明進行啟用。

Mallya®魔力芽™現在已準備好使用。
請按照下一部分「**使用Mallya®魔力芽™**」的說明進行操作。

使用 Mallya®魔力芽™

請參考您注射筆的使用者手冊，瞭解胰島素流程確認和注射操作。

如果您不确定是否已经注射胰岛素，请不要开始或重复注射。

請根據醫嘱監測治療情況和血糖值。如果您對治療情況有任何疑問，請諮詢您的醫護人員。


1. 在您開始選擇劑量之前，請確保筆的劑量視窗顯示數字0。數字0應該與筆的劑量指示線對齊。



2. 使用Mallya®魔力芽™裝置上的黑色劑量選擇按鈕選擇劑量。



3. 轉動Mallya®魔力芽™按鈕以選擇您需要的劑量。所選劑量應該與筆劑量指示線對齊。在選擇劑量時，Mallya®魔力芽™訊號燈顯示綠色。




注意：請勿使用Mallya®魔力芽™的透明蓋身來選擇您的劑量。

4. 按照注射筆的使用說明進行注射。按住Mallya®魔力芽™劑量選擇按鈕並保持不動。觀察劑量視窗返回到0。數字0必須與筆的劑量指示線對齊。在注射劑量時，Mallya®魔力芽™訊號燈顯示綠色。



5. 注射結束後，保持按壓按鈕並保持針頭在皮膚裡，直到綠色快速閃爍(6秒)。

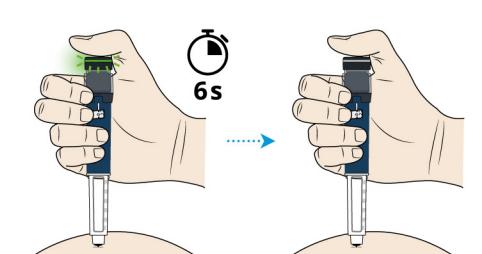

注意：Mallya®魔力芽™將自動檢測和記錄用於流程確認的安全測試。請按照注射筆的使用說明執行安全測試以流程確認。

故障排除

橙色 快速閃爍
筆的劑量視窗必須設定為0。當筆的劑量指示線與數字0對齊時，按住劑量按鈕2秒，直到Mallya®魔力芽™訊號燈變為綠色。



橙色 長亮
Mallya®魔力芽™的電量低。請插上電源為Mallya®魔力芽™充電(充滿電需要2小時)。如果電池電量不足，在注射過程中Mallya®魔力芽™訊號燈將變為**橙色**。



紅色 長亮
Mallya®魔力芽™處於錯誤狀態。在這種狀態下，Mallya®魔力芽™尚未準備好記錄注射。重設Mallya®魔力芽™並重新啟動。請參閱「**重設Mallya®魔力芽™**」章節。如果問題仍然存在，請聯絡客戶服務。



根據 IEC 60601-1-8 標準，紅色訊號不屬警報。

在正常使用條件下，Mallya®魔力芽™電池的最短續航時間為2週。

電池電量不足時，Mallya®魔力芽™訊號燈顯示**橙色**。



將Mallya®魔力芽™連接到提供的 USB 充電線，然後將充電線插上電源插座，即可為Mallya®魔力芽™充電。

不要使用任何其他充電線。

請將包裝內附的USB充電線連接到適合您所在地區的電源適配器(經 IEC/UL 60950-1 或 IEC/UL 62368-1 認證，帶有CE或UL標記)的USB連接埠。



充電時，Mallya®魔力芽™訊號燈會**緩慢地閃爍**綠色。



注意：電池充滿電後，Mallya®魔力芽™訊號燈會**熄滅**(充滿電需要2小時)。




將 Mallya®魔力芽™ 轉換至新的注射筆

1 關閉Mallya®魔力芽™


將Mallya®魔力芽™轉換到另一支注射筆之前，必須先關閉它，以便轉換裝置不會導致應用程式中的錯誤劑量紀錄。

- 用力按住Mallya®魔力芽™按鈕5秒鐘，直到其訊號燈變為紫色。然後，抬起手指。Mallya®魔力芽™訊號燈熄滅，表明Mallya®魔力芽™已關閉。

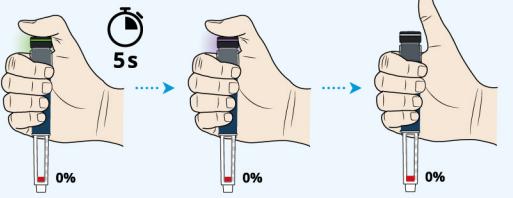

2 從注射筆上取下 Mallya®魔力芽™

- 握住Mallya®魔力芽™蓋身。




- 直接將Mallya®魔力芽™從注射筆上拔下。


- 將Mallya®魔力芽™豎直放在平面上，按鈕朝上。

3 將Mallya®魔力芽™組裝到新的注射筆上

- 將Mallya®魔力芽™安裝至注射筆上的劑量按鈕，並將Mallya®魔力芽™的凹槽對準注射筆上的劑量視窗。



- 用手掌按壓按鈕，將Mallya®魔力芽™完全安裝至注射筆中。必須將其完全貼合到劑量設定鈕上。




- 確保Mallya®魔力芽™如圖所示正確安裝在注射筆上。




4 在新的注射筆上啟用Mallya®魔力芽™

- 長按Mallya®魔力芽™按鈕 5 秒鐘，直至其訊號燈變為紫色。

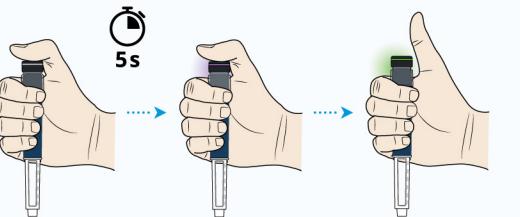


- 鬆開手指，Mallya®魔力芽™訊號燈變成綠色，表示Mallya®魔力芽™已經準備好可以使用。

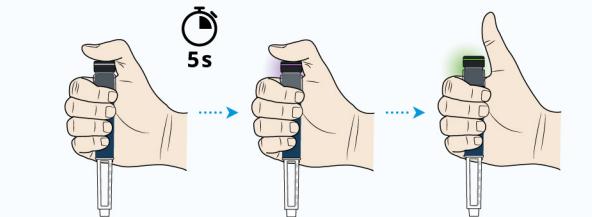


注意：如果Mallya®魔力芽™訊號燈未變成綠色，請確保Mallya®魔力芽™已充分安裝至您的注射筆上。重複「開始使用Mallya®魔力芽™」章節的2.3，將Mallya®魔力芽™安裝至注射筆上以完全貼合。然後按照步驟4.1中的說明進行啟用。

Mallya®魔力芽™現在已準備好使用。
請按照「[使用Mallya®魔力芽™](#)」章節的說明進行操作。

訊號燈的含義



**藍色
長亮**
Mallya®魔力芽™已經準備好配對。
在Mallya®魔力芽™配對之前，無論如何操作，訊號燈都顯示**藍色**。無數據記錄。



**紫色
長亮**
Mallya®魔力芽™正在被啟用或關閉。



**綠色
長亮**
Mallya®魔力芽™可能是：
• 已配對
• 正在選擇劑量
• 正在注射劑量




**綠色
緩慢閃爍**
Mallya®魔力芽™正在充電並已配對。



**綠色
快速閃爍**
Mallya®魔力芽™檢測到注射結束。
如果電池電量不足，注射過程中Mallya®魔力芽™訊號燈將變為**橙色**。



**橙色
長亮**
Mallya®魔力芽™的電量低。
請插上電源為Mallya®魔力芽™充電(充滿電需要2小時)。
如果電池電量不足，注射過程中Mallya®魔力芽™訊號燈將變為**紅色**。



**橙色
快速閃爍**
筆的劑量視窗必須設定為0。
當注射筆的劑量指示線與數字0對齊時，按住劑量按鈕2秒，直到Mallya®魔力芽™訊號燈變為**綠色**。



**紅色
長亮**
Mallya®魔力芽™處於錯誤狀態。
在這種狀態下，Mallya®魔力芽™尚未準備好記錄注射。重設 Mallya®魔力芽™並重新啟動。請參閱「[重設Mallya®魔力芽™](#)」章節。
如果問題仍然存在，請聯絡客戶服務。
根據 IEC 60601-1-8 標準，紅色訊號不屬警報。



無訊號

訊號燈在靜止一段時間(10秒)後會自動熄滅。
輕按Mallya®魔力芽™按鈕啟用它，並通過訊號燈的顏色查看其狀態。
如果訊號燈不亮，請長按按鈕5秒鐘，Mallya®魔力芽™可能已被關閉。
如果長時間用力按下按鈕，訊號燈仍然不亮，則可能是電池電量不足。請將您的Mallya®魔力芽™充電。

安全使用須知

如果出現副作用或事故，請聯絡製造商和相關的健康管轄機構。

不正確操作可能導致嚴重的傷害或死亡

- 如果您不确定是否已经注射药物，请不要开始或重複注射。请根据医嘱监测您的治疗情况。
- 请将Mallya®魔力芽™或其配件置于儿童无法触及的位置(有受伤、窒息和勒死的危险)。请勿在头部或颈部附近连接或拉紧充电线。
- 请勿将装置暴露在高於40°C(104°F)的温度下或火焰中。如果在超过我们建议的高温下使用Mallya®魔力芽™，装置表面的最高温度可能会达到43°C。在这种情况下，使用时间限制在10分钟以内，以避免任何燃烧风险。
- Mallya®魔力芽™包含磁鐵。为了保证最佳效果，请在使用过程中避免与金属部件接触，并避免在心律调节器、除颤器和穿戴式输液泵或磁共振成像(MRI)环境附近使用Mallya®魔力芽™。
- Mallya®魔力芽™包含磁铁。为了保证最佳效果，请在使用过程中避免与金属部件接触，并避免在心律调节器、除颤器和穿戴式输液泵或磁共振成像(MRI)环境附近使用Mallya®魔力芽™。

- 请勿在危险环境中操作装置：有爆炸危险，或含有揮發性溶劑(酒精等)或易燃物質(麻醉劑、富氧環境等)。
- Mallya®魔力芽™只能由已经熟悉注射笔的患者使用。请与您的医疗保健提供商或BIOCORP PRODUCTION授权经销商联络，以检查您常用注射笔的相容性。

使用不当可能導致人身傷害或財產損失

- 请勿将装置暴露在潮湿环境中。请勿将装置浸入液体中。

無線通訊的安全問題

- 便攜式射頻通訊裝置(包括天線電纜和外置天線等外圍裝置)與Mallya®魔力芽™裝置的任何部分(包括製造商指定的電纜)之間的距離不得小於30公分(12英寸)。否則可能導致裝置性能下降。
- 如果在使用裝置時出現任何異常氣味、聲音、發熱或冒煙，請停止使用Mallya®魔力芽™。
- 如果裝置受到外部機械衝擊(敲擊、碰撞、摔落等)或受到過度壓力(不恰當的儲存/運輸/使用條件)，可能會導致裝置故障。在裝置發生故障時，請在不使用裝置的情況下繼續使用您的注射筆治療。
- 請聯絡包裝外部所標示的 BIOCOP PRODUCTION 授權經銷商尋求技術支援。
- 如有明顯損壞，請勿使用Mallya®魔力芽™，並聯絡 BIOCOP PRODUCTION 或其授權經銷商以獲得技術支援。
- 請勿將Mallya®魔力芽™及其配件置於動物/昆蟲或灰塵/毛絨附近。使用後，必須將裝置放回包裝中。
- Mallya®魔力芽™只能與諾和諾德的諾特筆®一起使用。切勿將Mallya®魔力芽™與其他任何注射筆一起使用。
- 不建議視障人士在沒有經過培訓人員的幫助下使用此裝置。
- 在操作過程中，如果針頭已裝配在注射筆上，請使用筆帽保護針頭。
- 需要進行廢棄電子裝置(WEEE)的分離收集。
- 與嵌入式軟體版本相對應的網路安全術語可要

求提供。如需查詢，請聯絡 BIOCOP PRODUCTION 授權經銷商。

- 您有責任妥善保護和管理您的手機。如果您懷疑發生與Mallya®魔力芽™裝置或相關app有關的不利網路安全事件，請聯絡客戶服務。
- 請確保您的手機和Mallya®魔力芽™裝置存放在安全的地方，並在您的掌控之下。這對於防止任何人存取或篡改系統非常重要。
- Mallya®魔力芽™裝置所使用的應用程式不適用於已被更改或定制以移除、替換或規避製造商核准的配置或使用限制，或者以其他方式違反製造商固有條款的手機。
- 在極少數情況下，您可能得到不準確的胰島素劑量讀數。如果您認為讀數不正確或與您的感覺不一致，請進行手指血糖測試以確認您的血糖值。如果問題仍然存在，請聯絡客戶服務。
- 與Mallya®魔力芽™裝置一起使用的應用程式要求您的手機具有正確的日期和時間，以便記錄您的健康資訊。您手機的日期和時間應設定為自動更新。您可以在手機設定中進行檢查。
- 在使用與Mallya®魔力芽™裝置配套的應用程式時，應保持手機電量充足。
- 保持手機電量充足和開機狀態。
- 停用手機的作業系統自動更新。在進行作業系統更新後，開啟應用程式並檢查裝置設定，以確保其正常運作。
- 在丟棄Mallya®魔力芽™裝置之前：重設裝置以刪除所有您的個人健康數據。

使用注射筆治療的胰島素依賴型患者

18 至 80 歲的使用者

家用

測試測得 99% ±1

USB交換適配器(未提供)符合 IEC/UL 60950-1 或 IEC/UL 62368-1 認證，帶有 CE 或 UL 標誌。外部模組具有自動調節電壓功能，輸入電壓範圍為 90-264V。

5V 直流，≥ 500 毫安

鋰離子 3.6V 25mAh

最近 100 次的記錄儲存在裝置的內部記憶體中(包括胰島素流量紀錄)

藍牙低功耗 4.2 版本在 2400 MHz 到 2483.5 MHz 的波段上運行。

共有 40 個頻道，頻道間隔為 2 MHz，頻道頻寬為 1 MHz。最大傳輸功率為 4 dBm (相當於 2.519 毫瓦)。最大等效輻射功率(EIRP)為 -6 dBm

EFA1

韌體 1.2.x

40.1mm(h) x Ø25.8mm

11g

溫度
-10°C
濕度
10%
壓力
1060hPa

須始終使用原包裝，以防止損害。請保留所有原始包裝，以備將來使用(以防裝置退溫或運輸)

-10°C
40°C
10%
500hPa

溫度
-10°C
濕度
10%
壓力
1060hPa

2°C
35°C
15%
700hPa

溫度
-10°C
濕度
90%
壓力
1060hPa

2 年

裝置及/或其包裝和標籤上的符號和資訊

| 符號 | 說明 |
|----|--|
| | 遵循使用說明手冊 |
| | 使用者手冊 |
| | 製造商 |
| | 序號 |
| | 生產日期和國家 |
| | 批號 |
| | 醫療器材單一識別 |
| | 型號 |
| | 經銷商 |
| | 參考目錄 |
| | 經銷商參考 |
| | 有效日期 |
| | 醫療器材 |
| | BF 型應用零件(根據 IEC 60601-1連續模式) IP22 防護等級(IEC 60529) |
| | 直連電 |
| | 僅限室內使用 |
| | 避免潮濕 |
| | 如果包裝已損壞或打開，請勿使用 |
| | 廢棄電子電機裝置 |
| | 歐洲合格認證 |
| | 可供一位患者多次使用 |

更多資訊請參閱 my-mallya.com 的技術說明。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核準，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

聯繫方式和一般資訊

BIOCOP PRODUCTION
ZI LAUVA - LA BECHADE
63500 ISOIRE
FRANCE
Tel: +33473557050
www.biocorp.fr

經銷商
(授權經銷商):
經銷商詳情請參閱 Mallya®魔力芽™ 包裝盒背面。

Mallya®魔力芽™不是無菌的，僅能供單一病人重複使用。
如有必要，可以對Mallya®魔力芽™進行清潔：
• 如果Mallya®魔力芽™插在USB充電線上，請拔下充電線。
• 用柔軟的無絨布擦拭外部表面，必要時可以用少量中性清潔劑稍微浸濕無絨布再擦拭。
• 用軟布將表面擦乾。

無線通訊聲明